

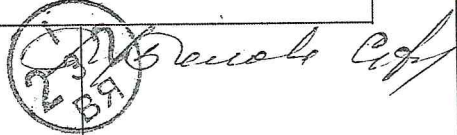
ИРВИС-РС4М-Ультра-800 зав.№ 29810 на основании результатов первичной поверки признан годным к эксплуатации с характеристиками, указанными в разделе "Сведения о поверке".
Контрольная сумма: C4CA0EB12DEA

Дата поверки _____

Подпись поверителя _____

Срок очередной поверки _____

М.П.

| Дата | Поверка произведена | Подпись поверителя | Срок очередной поверки |
|--|---------------------|--------------------|---|
| <p>В составе ПП: первичный преобразователь давления (ППД) сенсор абсолютного давления ICS86 Рабс <u>2,5</u> (bar) зав.№ <u>21137</u>, первичный преобразователь температуры ТПТ-17-2 (-40...+60 С) № <u>17356</u>. Контрольная сумма <u>F038 E43E C435</u></p> | | | |
| 24.02.2022г | поверка | выполнена |  |

О результатах поверки счетчика газа и датчика температуры можно узнать на сайте ООО "Ирвис Север" irviss.ru (кнопка "Результаты поверок СИ") или на сайте Федерального информационного фонда по обеспечению единства измерений fgis.gost.ru

ИРВИС-РС4М-Ультра

ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ
ОБЩЕСТВО
«ТЕРМИКО»

Аттестат аккредитация в области
обеспечения единства измерений
№ РОСС RU.0001.310383

СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПОВЕРКЕ № С-ГПЯ/09-11-2021/107579638

Действительно до 8 ноября 2025 г.

Средство измерений Термометр сопротивления из платины технический
наименование, тип, модификация средства измерений, регистрационный номер в
ТПТ-17-2 (Пер. № 46155-10)

Федеральном информационном фонде по обеспечению единства измерений, присвоенный при утверждении типа
заводской (серийный) номер 17356
в составе _____

поверено в полном объеме
наименование единиц величин, диапазонов измерений, на которых поверено средство измерений
в соответствии с ГОСТ 8.461-2009

с применением эталонов: 11804.99.1P.51435, 19973.06.4P.00231737
наименование или обозначение документа, на основании
которого выполнена поверка

регистрационный номер и (или) наименование, тип,
(ПТС-10 №2075, 1р.; АСПТ №22-472, ПГ ±0,002 Ом; ТПП-1 №172, ПГ ±0,01 °С; ТН-1М №005, ПГ ±0,01 °С)
заводской номер, разряд, класс или погрешность эталонов, применяемых при поверке
при следующих значениях влияющих факторов: температура: 21 °С;

перечень влияющих факторов
относительная влажность: 51 %; атмосферное давление: 98.6 кПа;
при которых проводилась поверка, с указанием их значений

и на основании результатов первичной (периодической) поверки признано
пригодным к применению.

Постоянный адрес
записи сведений о
результатах поверки в
ФИФ ОЕИ: <https://fgis.gost.ru/fundmetrology/cm/results/1-107579638>

Номер записи сведений
о результатах поверки в
ФИФ ОЕИ: 107579638

Поверитель Ерохина О. Б.
Знак поверки: 2 гп я 1
фамилия, инициалы

И.о. главного метролога Ушаков А.С.
Должность руководителя или
другого уполномоченного лица Ушаков А.С.
подпись фамилия, инициалы

Дата поверки 9 ноября 2021 г. Бланк № 2107483